

2025 年紊流儀 VMP-250 校驗

- 序號：SN474
- 最近原廠校正日期：溫度(2022/10/24)、導電度 (2022/10/24)、葉綠素(2022/11/16)
- 時間：2025 年 06 月 02 日
- 航次：NOR2-0157
- 貴重儀器中心校驗項目：溫度、鹽度




圖 1、紊流儀 VMP-250 SN474 之(a)溫度、(b)導電度與(c)鹽度資料與新海研 2 號 CTD 資料比較。

NOR2-0157




圖 2、紊流儀 VMP-250 SN474 之(a)溫度與(b)鹽度資料和新海研 2 號 CTD 資料比較。



- 時間：2025 年 06 月 02 日
- 航次：NOR2-0157
- 貴重儀器中心校驗項目：溫度、鹽度

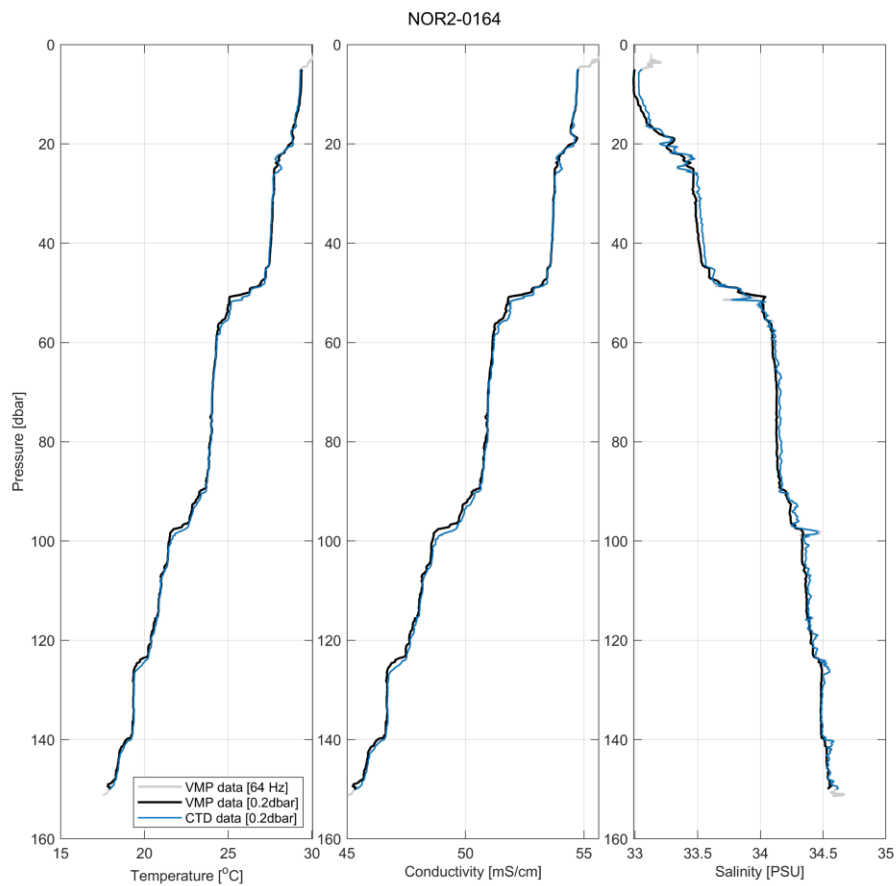


圖 3、紊流儀 VMP-250 SN474 之(a)溫度、(b)導電度與(c)鹽度資料與新海研 2 號 CTD 資料比較。

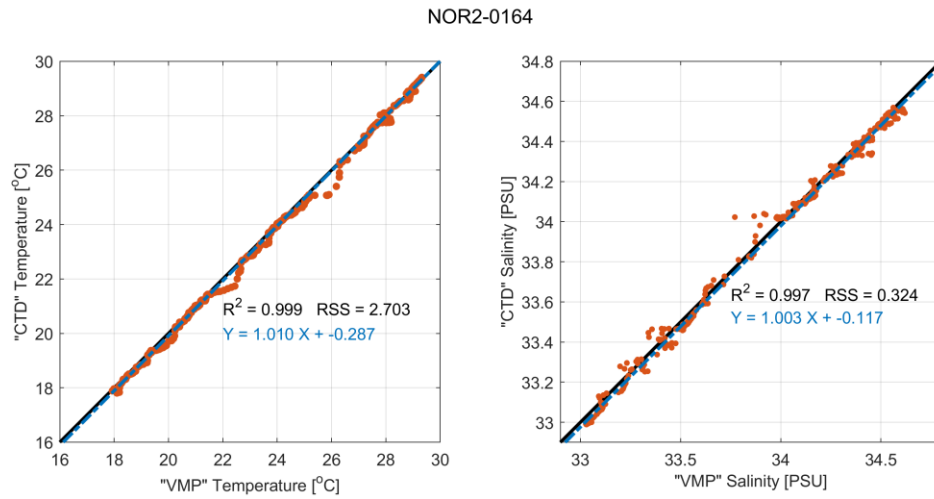


圖 4、紊流儀 VMP-250 SN474 之(a)溫度與(b)鹽度資料和新海研 2 號 CTD 資料比較。

